

PRODIGY AutoCode®

Blood Glucose Monitoring System

Quick Reference Guide




Speaks In 4 Languages


AQR16_Rev5. 04/17

Adjustable Depth Lancing Device


Directions For Use

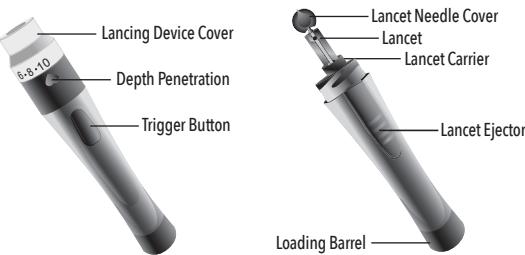

Twist off the Lancing Device Cover.



Insert a sterile Lancet firmly into the Lancet Carrier.



Hold the Lancet Needle Cover and gently twist it off the Lancet.

Thank you for choosing the Prodigy AutoCode® Blood Glucose Monitoring System.

This quick reference offers easy instructions on how to use the Prodigy AutoCode® meter effectively.

Blood Glucose Testing

Wash your hands and the intended testing site before using the system and after obtaining a blood sample.


Only use fresh capillary blood samples for testing. Always use a new, sterile lancet and keep the lancing device clean.

Applying Blood Correctly

With the test strip inserted into the meter, bring it to the test site and place the tip next to the blood drop.


Blood will automatically be drawn into the absorbent channel once the test strip is close enough.

Do not smear blood onto the test strip or place the blood on top of the test strip.



Confirmation Window

If the absorbent channel is not full, add more blood. The meter will beep once the channel is full.



Performing a Blood Glucose Test

1 Insert Test Strip

Insert the test strip and the meter will power on automatically. **No Coding Required.**

"Your Prodigy meter is on... Please apply blood into the test strip."



2 Apply the Blood Sample

When "滴" appears, apply blood.

The meter will **beep**.


"Testing."



The meter will count down from 6 to 1.



Re-cap the Lancing Device Cover.



The Adjustable Tip offers 10 levels of skin penetration. To select the desired depth, twist the Adjustable Tip in either direction until the preferred setting lines up with the arrow.

TO SELECT THE BEST DEPTH

- 1 - 3 For soft or thin skin
- 4 - 6 For average skin
- 7 - 10 For thick or calloused skin



Slowly pull the Loading Barrel away from the Lancing Device until you hear a click, indicating that the Lancet Carrier is locked into position.


Release the Loading Barrel to return it to its original position.



Position the end of the Adjustable Tip against the side-tip of the finger or alternate testing site. Press the Trigger Button and then lift the Lancing Device away from the testing site after the puncture is complete.



Wait a few seconds for a blood drop to form. To help form a blood drop, gently massage the testing area.



Remove the Lancing Device Cover and push the Lancet Ejector to release the Lancet from the Lancet Carrier. Dispose of the used Lancet into the appropriate Sharps or Bio-hazard container.



Taking Care of your Adjustable Depth Lancing Device

- Wipe your Prodigy Lancing Device with a PDI Super Sani-Cloth Germicidal Disposable Wipe.
- Do not immerse the lancing device in any liquids.
- Do not use bleach.
- Disinfect your lancing device twice a week.

After cleaning the device, unscrew the Lancing Device Cover; wipe it with a PDI Super Sani-Cloth Germicidal Disposable Wipe for two (2) minutes. Make sure the Device Cover is completely dry before reattaching it to the device.

WARNING: To reduce the risk of infection, **DO NOT** share or re-use a lancet. Always use a new, sterile lancet. **DO NOT** share the lancing device with another person. If you are assisting someone with the process of obtaining a blood sample, it is recommended that you wear protective gloves to reduce the risk of contact with blood-borne pathogens.

3 Hear and See Test Results

"Blood glucose, 103 milligrams per deciliter."



Recalling Test Results

The meter stores 450 of the most recent blood glucose test results, with date and time (in its memory).

With the meter turned off, press and hold the "M" button to turn the meter on. Press the "M" button again to enter memory mode and the 7-day average will appear.

If you continue to press the "M" button, the 14 and 28 day averages will appear.

After the averages, you will be able to review the individual test results stored in the memory.

2017 Prodigy Diabetes Care, LLC. Prodigy®, AutoCode®, and Prodigy AutoCode®, are registered trademarks of Prodigy Diabetes Care, LLC. All rights reserved.


IMPORTANT

- All parts of the system are considered biohazardous and can potentially transmit infectious diseases, even after cleaning and disinfection.
- Do not use the Prodigy AutoCode® Blood Glucose Monitoring System during or after a Xylose Absorption Test. This may falsely raise glucose results. Please check with your Doctor before using the Prodigy AutoCode® Blood Glucose Monitoring System.
- The system exhibits interference from Acetaminophen, ascorbic acid and Ibuprofen. If you are taking acetaminophen containing drugs (Tylenol, etc., >8.0 mg/dL in your blood), or ibuprofen containing drugs (Advil, etc., > 50.0 mg/dL in your blood) or vitamin C (ascorbic acid, > 5.0 mg/dL in your blood), you may obtain inaccurate readings from this blood glucose monitoring system. Please check with your doctor before using the Prodigy AutoCode® Blood Glucose Monitoring System.
- High uric acid concentrations (>8 mg/dL in your blood) may interfere with the glucose measurements with this device. If you have medical conditions that are associated with high uric acid level or hyperuricemia (e.g. gout), then please check with your Doctor before using the Prodigy AutoCode® Blood Glucose Monitoring System.
- Refer to the Prodigy AutoCode Blood Glucose Monitoring System Owner's Manual for complete list of warnings, limitations and error messages.

PRODIGY AutoCode®

Sistema de monitoreo de glucosa en sangre

Guía de consulta rápida

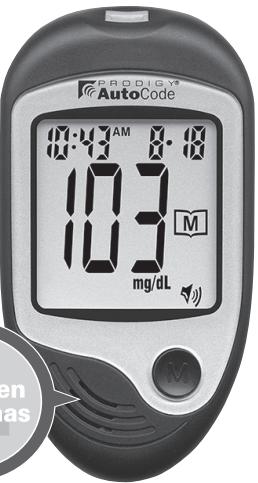

Audio en
4 Idiomas

AQR16_Rev5. 04/17

Dispositivo de punción de profundidad ajustable

Modo de empleo



1 Desenrosque el capuchón del dispositivo de punción.

2 Inserte con firmeza la lanceta estéril en el portalancetas.

3 Sostenga el protector de la aguja de la lanceta y desenróquelo suavemente de la lanceta.

Gracias por elegir el sistema de monitoreo de glucosa en sangre Prodigy AutoCode®.

Esta referencia rápida le ofrece instrucciones fáciles sobre cómo usar eficazmente el medidor Prodigy AutoCode®.

Prueba de glucosa en sangre

Lávese las manos y el sitio previsto para la prueba antes de usar el sistema y después de obtener una muestra de sangre.

Utilice solo muestras frescas de sangre capilar para la prueba.


Siempre utilice una lanceta nueva y estéril y mantenga limpio el dispositivo de punción.

Aplicación correcta de la sangre

Con la tira reactiva insertada en el medidor, llévela al sitio de prueba y coloque la punta al lado de la gota de sangre.

La sangre se extraerá automáticamente hacia el canal absorbente una vez que la tira reactiva esté lo suficientemente cerca.

No unte la sangre en la tira reactiva ni coloque sangre encima de la misma.



Vuelva a enroscar el capuchón del dispositivo de punción.



La tapa ajustable ofrece 10 niveles de penetración cutánea.

Para seleccionar la profundidad deseada, gire la tapa ajustable en cualquier dirección hasta que la marca quede alineada con la flecha.

PARA SELECCIONAR LA PROFUNDIDAD ADECUADA

- 1 - 3 Para piel suave o delgada
- 4 - 6 Para piel normal
- 7 - 10 Para piel gruesa o callosa



Retire lentamente el cartucho de lancetas del dispositivo de punción hasta escuchar un clic, lo que indica que el portalancetas se ha ajustado en la posición correcta.

Suelte el cartucho de lancetas para volver a la posición original.



Coloque el extremo de la tapa ajustable sobre la yema del dedo o el sitio alternativo. Pulse el botón disparador y luego retire el dispositivo de punción del sitio de prueba una vez que se haya realizado la punción.

Ventana de confirmación

Si el canal absorbente no está lleno, añada más sangre. El medidor emitirá un pitido cuando el canal esté lleno.



Procedimiento de una prueba de glucosa en sangre

1 Inserción de la tira reactiva

Inserción de la tira reactiva y el medidor se encenderá de manera automática. Sin codificación requerida.

"Su medidor Prodigy está encendido..."

Por favor, aplique sangre en la tira reactiva".

2 Aplicación de la muestra de sangre

Cuando se muestra "0", aplique la sangre.

El medidor emitirá un pitido.

"Midiendo".

El medidor hará una cuenta regresiva desde 6 hasta 1.



Aguarde unos segundos hasta que se forme una gota de sangre. Para favorecer que se forme una gota de sangre, masajee suavemente la zona de prueba.



Retire el capuchón del dispositivo de punción y pulse el expulsor de lancetas para quitar la lanceta del portalancetas. Deseche la lanceta utilizada en un recipiente adecuado para objetos punzantes o residuos biológicos peligrosos.



Cómo mantener su dispositivo de punción de profundidad ajustable

- Limpie su dispositivo de punción Prodigy con un paño germicida desechable PDI Super Sani-Cloth.
- No sumerja el dispositivo de punción en líquidos.
- No utilice blanqueador.
- Desinfecte su dispositivo de punción dos veces por semana.

Una vez que ha limpiado el dispositivo, desenrosque el capuchón del dispositivo de punción y límpielo con un paño germicida desechable PDI Super Sani-Cloth durante dos (2) minutos. Asegúrese de que el capuchón del dispositivo esté completamente seco antes de volver a colocarlo.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de infección, NO comparta ni reutilice una lanceta. Siempre utilice una lanceta nueva y estéril. NO comparta el dispositivo de punción con otras personas. Si está ayudando a una persona con el proceso de obtención de muestra de sangre, se recomienda que utilice guantes de protección a fin de reducir el riesgo de contacto con agentes patógenos transmitidos por sangre.

3 Escuchar y ver los resultados de la prueba

"Glucosa en sangre, 103 miligramos por decilitro".



Recordatorio de los resultados de la prueba

El medidor almacena los últimos 450 resultados de pruebas de glucosa en sangre, con fecha y hora (en su memoria).

Con el medidor apagado, mantenga presionado el botón principal "M" para encenderlo. Vuelva a presionar el botón principal "M" para acceder al modo de memoria; se mostrará el promedio para 7 días.

Si continúa presionando el botón principal "M", visualizará el promedio de los últimos 14 y 28 días.

Después de los promedios, podrá revisar los resultados de prueba individuales almacenados en la memoria.



2017 Prodigy Diabetes Care, LLC. Prodigy®, AutoCode® y Prodigy AutoCode® son marcas registradas de Prodigy Diabetes Care, LLC. Todos los derechos reservados.

IMPORTANTE

- Se considera que todas las partes del equipo constituyen elementos biológicos peligrosos y que pueden transmitir enfermedades infecciosas, incluso cuando han sido limpiadas y desinfectadas.
- No utilice el sistema de monitoreo de glucosa en sangre Prodigy AutoCode® durante o después de una prueba de absorción de la xilosa. El dispositivo puede arrojar resultados altos falsos del nivel de glucosa. Consulte a su médico antes de utilizar el sistema de monitoreo de glucosa en sangre Prodigy AutoCode®.
- El sistema presenta interferencias con el uso de paracetamol, ácido ascórbico e ibuprofeno. Si está tomando medicamentos que contienen paracetamol (Tylenol, etc., >8.0 mg/dL en sangre) o ibuprofeno (Advil, etc., >20.0 mg/dL en sangre) o vitamina C (ácido ascórbico, >5.0 mg/dL en sangre), es posible que obtenga valores incorrectos en el sistema de monitoreo de glucosa en sangre. Consulte a su médico antes de utilizar el sistema de monitoreo de glucosa en sangre Prodigy AutoCode®.
- Una concentración alta de ácido úrico (>8 mg/dL en sangre) puede interferir con la medición de glucosa del dispositivo. Si tiene alguna enfermedad relacionada con niveles altos de ácido úrico o hiperuricemia (por ejemplo, gota), consulte a su médico antes de utilizar el sistema de monitoreo de glucosa en sangre Prodigy AutoCode®.
- Consulte el manual del propietario del sistema de monitoreo de glucosa en sangre Prodigy AutoCode, para ver una lista completa de las advertencias, las limitaciones y los mensajes de error.